AYUMiEYE

あなたの「歩き」を見える化する、「アユミ アイ」。

取扱説明書

■お買い上げいただきありがとうございます。

■安全に正しくお使いいただくため、
ご使用前にこの取扱説明書を
必ずお読みください。

■本書は、いつもお手元に
置いてご使用ください。

品質保証

このたびは、GEヘルスケア商品をお買い求めいただきありがとうございました。商品は厳重な検査をおこない高品質を確保しております。しかし通常のご使用において万一、不具合が発生しましたとき、モジュールにつきましては保証規定により商品のお買い上げ後、1年間は無償修理または交換いたします。本製品には、製品保証書や購入店と日付を押印したシールを同梱しておりません。お買い上げ時の納品書を購入日証明としてご利用ください。

発売元 / GEヘルスケア・ジャパン株式会社
〒191-8503 東京都日野市旭が丘4-7-127

保証規定

1. モジュールは、取扱説明書の注意書きにしたがった正常な使用状態で、お買い上げ後1年以内に故障した場合には無償修理または交換いたします。
2. 無償保証期間内に故障して修理を受ける場合は、GEヘルスケア・ジャパン カスタマー・コールセンターにご連絡ください。
3. 無償保証期間内でも次の場合には有償修理になります。
   (イ) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。
   (ロ) お買い上げ後の落下・水没などによる故障および損傷。
   (ハ) モジュール以外の消耗品。
   (ニ) 火災、地震、水害、落雷、そのほかの天災地変、公害などによる故障および損傷。
   (ホ) 故障の原因が本商品以外に起因する場合。
   (ヘ) その他取扱説明書に記載されていない使用方法による故障および損傷。

安全上の注意

この取扱説明書では、製品を安全に正しくお使いいただき、お客様や他の人々への危害や財産の損害を防止するためにいろいろな絵表示で説明します。

⚠警告	この表示の欄は「死亡または重傷を負う危険が想定される内容」です。	⃠	してはいけない「禁止」内容です。
⚠注意	この表示の欄は「傷害を負う危険または物的損害が発生する危険が想定される内容」です。	❗	必ず実行していただく「強制」内容です。

⚠警告

⃠
- 電池(パッチ)やモジュールを乳幼児の手の届くところに置かないでください。誤飲やけがの恐れがあります。
- 電池(パッチ)やモジュールを飲み込んだ場合は、直ちに医師と相談してください。
- 電池(パッチ)は絶対に火中へ投げ込まないでください。破裂するおそれがあります。

⚠注意

❗
- 歩行評価中に異常が見られた際には、直ちに測定を中止し、適切な処置を行ってください。

取扱、保管、お手入れについて

⃠
- モジュールは絶対に分解しないでください。故障の原因になります。
- 過度な振動や衝撃を与えないでください。故障の原因になります。
- 皮膚が弱い方に、また湿疹、かぶれ、傷口がある場合には、その箇所に、パッチを貼付しないでください。
- 一度、皮膚に貼付したパッチは、別の人の皮膚に貼付しないでください。感染の原因になります。
- 水のかかるところで使用したり、保管をしないでください。
- アルコール、シンナーやベンジンなどを使用してお手入れをしないでください。

❗
- 測定時にパッチがずれると正しく測定できません。
- ご使用前にパッチの粘着力をご確認ください。

内容物一覧

・モジュール　・取扱説明書

各部の名称

1. モジュール本体

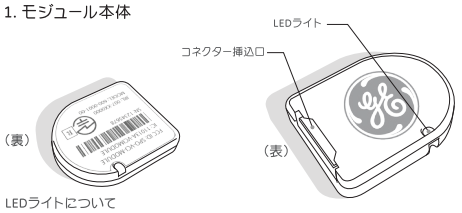

LEDライトについて

ランプの色でパッチの電池の状態をお知らせします。ランプはモジュールをパッチのコネクターに挿し込むと3秒間点灯します。ランプが緑に点灯したら、パッチの電池は十分に残っていることを示します。オレンジに点灯したら、パッチの電池の残量が少なく交換時期であることを示します。

注：モジュールをパッチのコネクターに挿し込んでもLEDライトが点灯しない場合、パッチの電池の残量は無いことを示します。

2. パッチ（別売り）

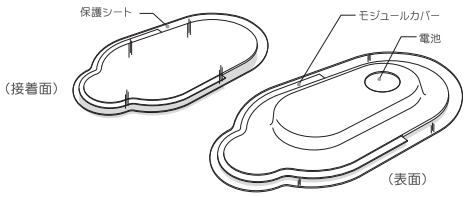

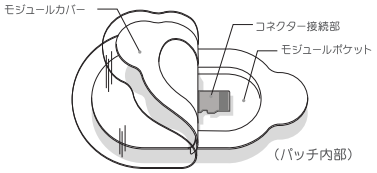

「おかしいな?」と思ったら

こんなとき	原因	対処の仕方
モジュールのランプがつかない	正しく装着されていない	モジュールの装着を確認してください 正しい向きで装着してください
	電池残量が少ない	新しいパッチに交換してください
モジュールに接続できない	電池残量が少ない	新しいパッチに交換してください
	モジュールが遠くにある	モジュールとiPhoneを近づけて再確認してください
	他のiPhoneに接続されている	iPhoneの設定をやり直してください
測定できない	モジュールが正しくパッチに挿し込まれていない	モジュールの装着を確認してください 正しい向きで装着してください
	他のモジュールに設定されている	複数のモジュールをご使用の場合は今一度接続するモジュールをご確認ください
	電池残量が少ない	新しいパッチに交換してください
	歩行評価が正しくできていない	推奨歩行評価(10m歩行テスト)を実行してください
	測定したい患者IDに有効なライセンスが付与されていない	有効なライセンスが付与されているかを管理者サイトで確認して ください。
上記以外	—	ヘルプをご覧ください

仕様

モジュール仕様	
電源電圧	-
測定機能	3軸加速度
メモリ	1.6Mbyte
通信方式	Bluetooth Low Energy (part of BT4.0)
通信距離	~10m
使用環境	気温10~45℃ 湿度10~95% 結露していなこと
電池寿命	-
外形寸法	25.4×21.9×4.5 mm
質　量	2.4g
その他	-

パッチ仕様	
電源電圧	1.4V (PR2330 空気/亜鉛電池)
測定機能	-
メモリ	-
通信方式	-
通信距離	-
使用環境	気温10~45℃ 湿度10~95% 結露していなこと
電池寿命	製造日より1年間(未開封)、6日間(開封)
外形寸法	77.5×37.8×6.0 mm
質　量	6.0g
その他	5回まで再貼付可能

※Bluetooth®とそのロゴマークは、Bluetooth SIG, INC所有する登録商標であり、株式会社GEヘルスケア・ジャパンはライセンスに基づいて使用しています。 ※iPhoneは、Apple Inc.の商標登録です。 ※その他記載されている会社名、製品名は各社の商標または商標登録です。

問い合わせ先

GEヘルスケア・ジャパン カスタマー・コールセンター

フリーダイヤル 0120-202-021

お問い合わせ時間　平日AM9:00-PM5:00 (土日祝日・年末年始を除く)

使用・保管方法（使い方）

■ハードウエア



1. モジュールを挿す
（裏表を確認し挿してください）



2. パッチを腰椎の3番(L3付近)に装着し歩行評価をしてください
(10mを適正距離に設定しています。評価時間が不十分だと結果が正しく表示されない可能性があります)
(2秒後に評価を開始してください)



3. 剥がす



4. モジュールを抜く



5. パッチをしまう

■ソフトウエア

iPhoneで設定する

1 iPhoneの「設定」から、Bluetooth®を「オン」にする
2 下記のサイトへアクセスする
www.ayumieye.gehealthcare.co.jp
3 「AYUMI EYEアプリ」をダウンロードする
4 アプリを起動して、ログインする
はじめてご利用いただく場合は、会員登録をしてください。
5 モジュールをパッチに接続する
モジュールのランプがついているのを確認する
アプリ画面の指示に従って接続してください。

注：初期設定項目の入力を間違えると、正しく測定できない場合があります。
iPhoneを機種変更した時には、再度設定を行ってください。

PCでライセンスを設定する

1 ライセンス（別売）を購入してください。
2 管理者サイトにアクセスして、
患者登録をしてください。
3 測定したい患者IDに発行済みのライセンス番号を
付与してください。

詳しくはwebをご覧ください

＊正しい使用方法をお守りいただけない場合は品質に責任を負いかねます。

データ転送について

・本商品は電波法に基づく工事設計認証を受けた2.4GHz帯省電力データ通信システムの無線設備です。本商品を改造、分解、本体記載の認証番号を消さないでください。電波法に抵触する恐れがあります。
・本商品を本商品と同じ周波数を使用した無線LAN、電子レンジ、無線機器などの周辺でご使用になりますと、本商品との間で電波干渉が発生する可能性があります。電波干渉が発生した場合、使用しない機器を停止するか、本商品の使用場所を変えるなど電波干渉の生じない環境で使用してください。
・電波を使用している関係上、第三者が故意または偶然に傍受する事も考えられます。機密を要する重要な事柄や人命に関わることには使用しないでください。
・本商品は日本国内専用です。日本国外で使用しないでください。海外で使用されると、その国の電波法に抵触する恐れがあります。
・スマートフォンやパソコンの取扱説明書をよく読んでから使用してください。故障の原因になります。
・通信中はICカードなど他の通信媒体、金属、磁石など磁界を発生させるものを通信エリアマークに近づけないでください。故障やデータ破損の原因になります。
・通信中に本体の電池を交換しないでください。故障やデータ破損の原因になります。

電波干渉に関するご注意

本商品の使用周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ライン等で使用される移動体識別用構内無線局、および免許を要しない特定小電力無線局、アマチュア無線局等（以下、「他の無線局」と略す）が運用されています。
1 本商品を使用する前に、近くで「他の無線局」が運用されていないことを確認してください。
2 万一、本商品と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合は、速やかに使用場所を変えるか、商品の使用を停止（電波の発信を停止）してください。
3 その他、電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、弊社カスタマーコールセンターまでお問い合わせください。

次のマークは電波の種類と干渉距離を表しています。



全帯域を使用し、移動体識別装置の帯域を回避可能です。

容器包装リサイクル法

プラ：パッチ・個包装 モジュール・トレー　紙：箱・取扱説明書

廃棄の際は、各地方自治体の区分、方法にしたがってください。

廃棄方法

使用済製品の廃棄の際は、各地方自治体の区分、方法にしたがってください。

医療機器ではありません（診断用ではありません）

医療機器ではありません、診断等の医療行為には使用しないでください。